

广东省招采子系统耗材报价操作手册

1. 登录与退出

1.1 访问入口

打开浏览器，输入地址：
<https://igi.hsa.gd.gov.cn/web/#/Index>，展示广东省医保服务平台登录页面，如图（1）所示。



图（1）

1.2 用户登录


（1）在登录界面选择“单位/经办人登录”后输入用户名、密码、验证码，如图（2）。



图（2）

（2）广东省省内医疗机构用户登录成功点击“招采企业服务”，点击“省平台交易模块”图片进入“药品与医用耗材招采子系统”

（3）进入系统后界面如图（3）所示，点击“耗材集中采购管理”图标，进入耗材招标管理系统界面。

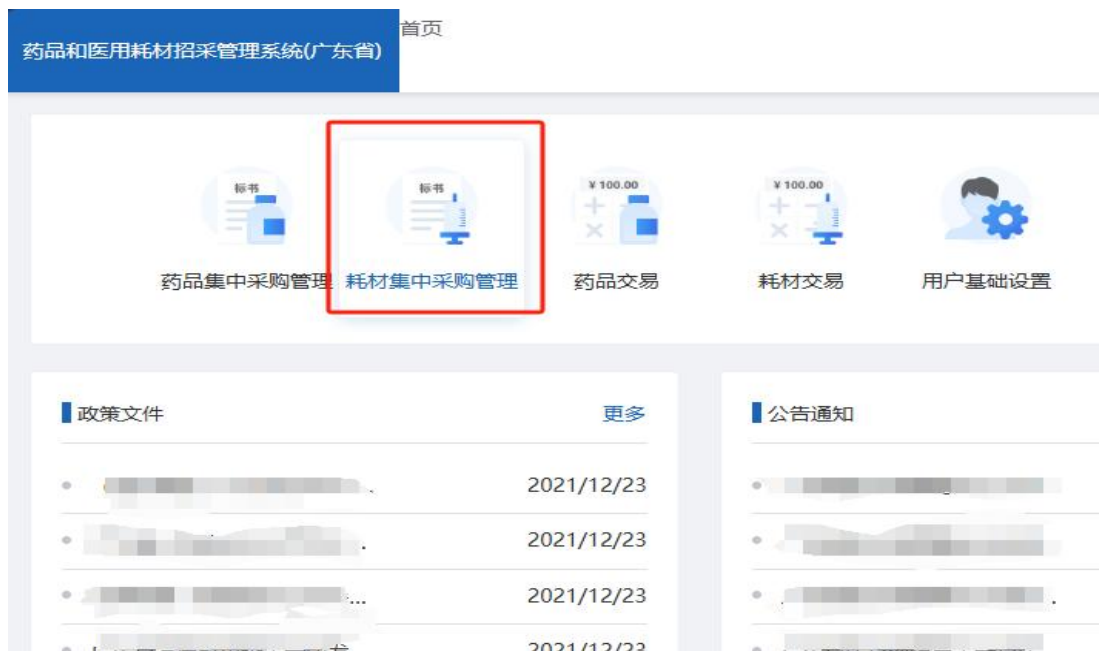

图（3）

2. 企业-耗材报价


注意事项：

ca 驱动是否安装，点击报价页面右上角 ca 证书测试，插上 ca 点击数字证书检测，看是否成功，如果未成功，请点击右上角 ca 驱动下载驱动进行安装，安装过程中请关闭杀毒软件，安装成功后，再次点击 ca 证书测试，确保 ca 能够正常输出。

ca 提示的密码输入是当前绑定的 ca 的正确密码，请确认好，如果输入错误报价会提交不了。


确认当前的 ca 是本公司的 ca，如果是用其他公司 ca 和操作人不是一家公司，报价的话会提示请使用当前登录公司的 ca，请确认好是否是本公司的 ca。

具体报价要求见采购文件第二部分第三项“企业报价要求”。

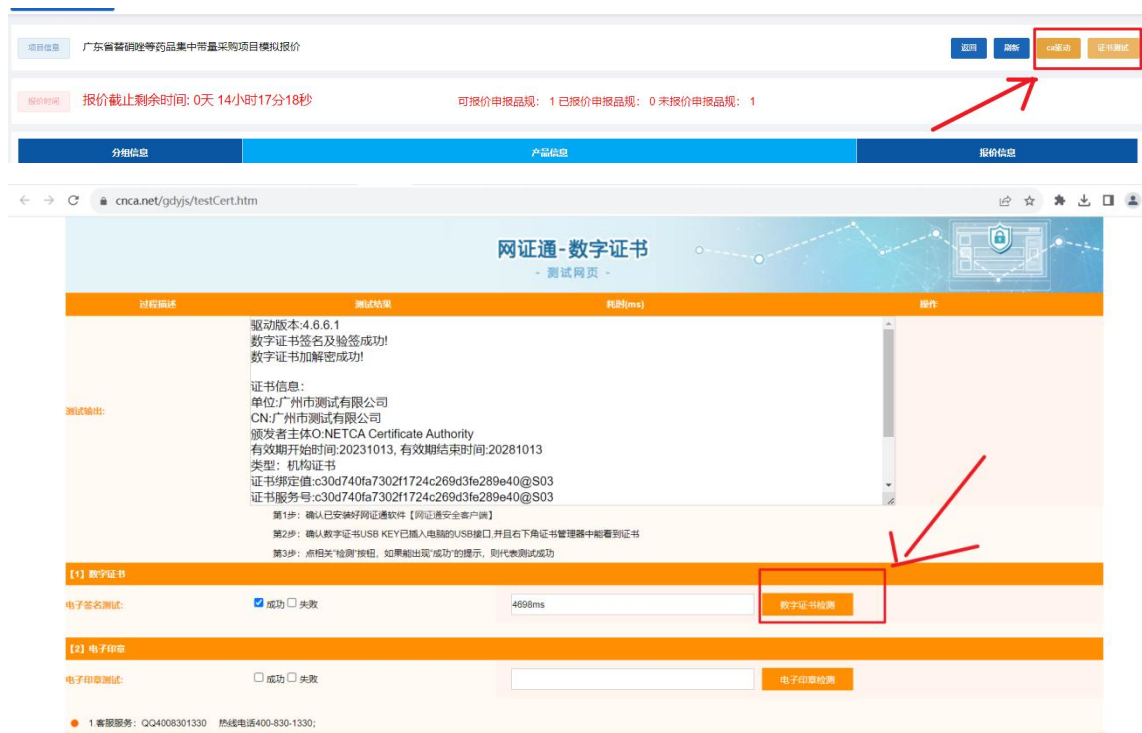

2.1 耗材企业报价项目列表

(1) 企业登录进入系统后在“耗材报价”菜单点击进入，如下图：

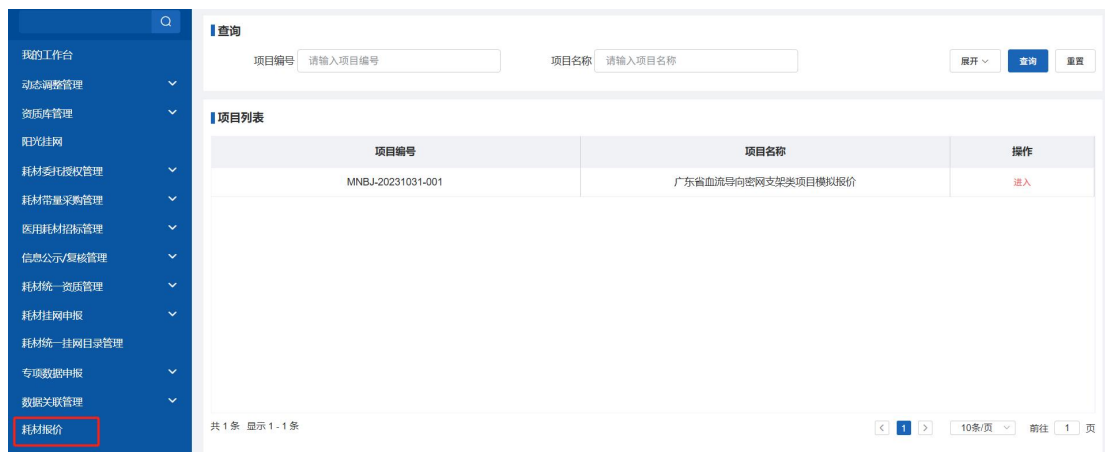


图（12）

在页面上点击【查询】按钮，可针对相关数据进行条件查询。

(2) 项目正式报价时间开始后，企业在操作栏中点击“进入”，如下图：




(3) 进入到项目内后，点击注册证号可弹框显示注册证具体的规格型号信息，如下图：

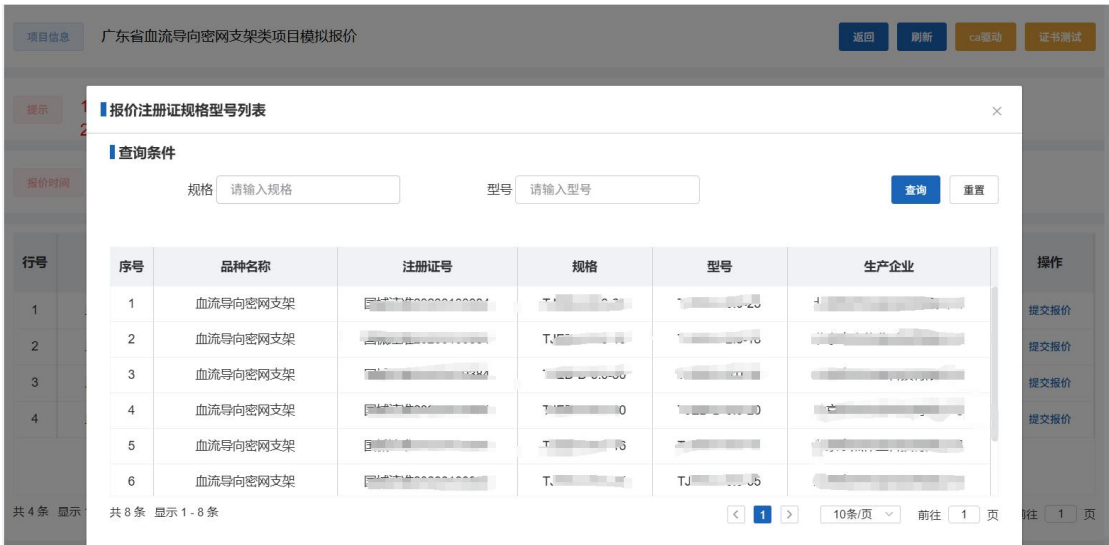


图（15）

（4）输入报价价格后，点击“提交报价”，弹出如下窗口：

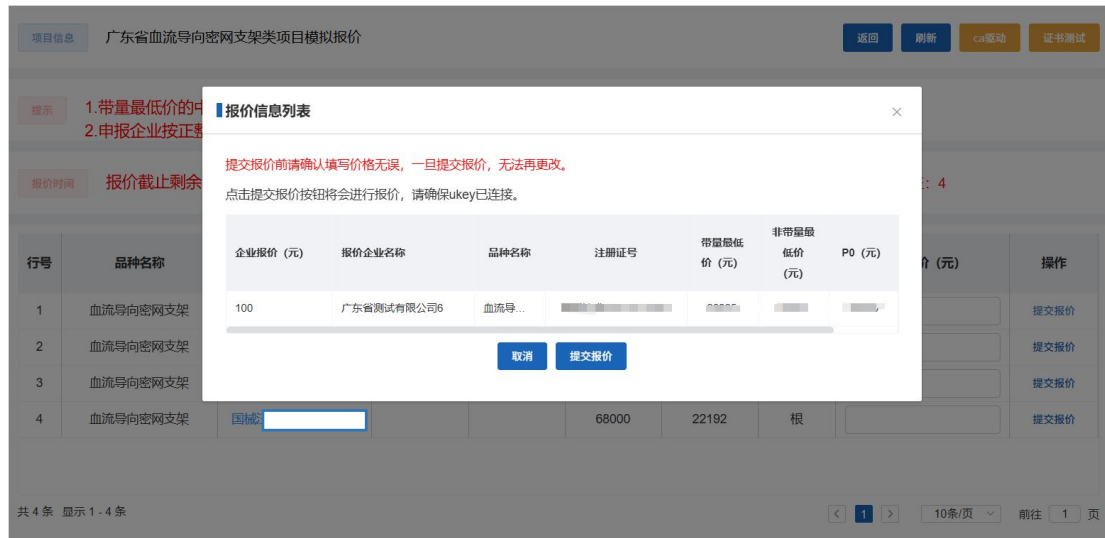

图（16）

（5）安装 CA 驱动并插入企业 CA 后，再次点击“提交报价”，根据提示输入 CA 密码，如下图：

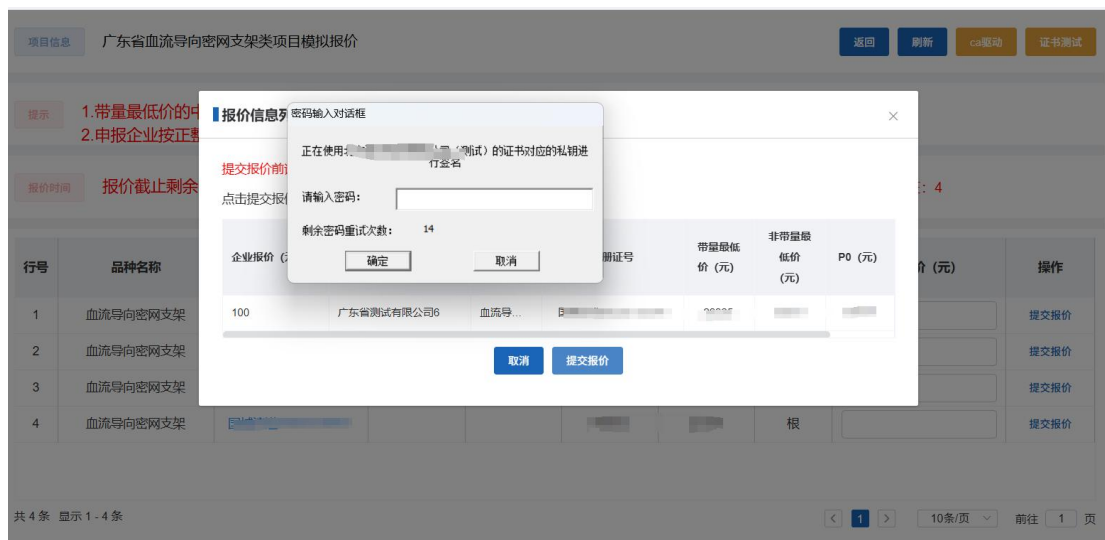

图（17）

（6）最后点击“确定”提示“报价成功”完成报价，如下图：

项目信息

广东省血流导向密网支架类项目模拟报价

返回

刷新

ca驱动

证书测试

报价成功!

报价时间

报价截止剩余时间: 14小时14分34秒

可报价申报注册证: 4 已报价申报注册证: 1 未报价申报注册证: 3

行号	品种名称	注册证号	带量最低价 (元)	非带量最低价 (元)	P0 (元)	带量最低价的中位数 (元)	报价单位	企业报价 (元)	操作
1	血流导向密网支架						根	已提交待解密	
2	血流导向密网支架						根		提交报价
3	血流导向密网支架						根		提交报价
4	血流导向密网支架						根		提交报价

共 4 条 显示 1 - 4 条

< 1 >

10条/页

前往 1 页

图（17）

注意：报价确认上报后，则无法撤回。